



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fl. nº 1014 PROCESSO nº 9090/2021

**4º LAUDO DE AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**REF.:** Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 038/2021.

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais Médico Hospitalares (máscaras).

**À 1ª Comissão Permanente de Licitação**

**Senhora Pregoeira,**

Considerando as informações apresentadas pela empresa **TER 3 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI**, arrematante do **LOTE 15**, a equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde entendeu ser necessário a realização de diligência, junto à empresa, para sanar dúvidas geradas pela incompatibilidade nas documentações disponibilizadas, conforme relato no e-mail, anexo ao laudo.


Entretanto, após retorno da empresa, as divergências permaneceram, onde foi apresentado catálogo do produto, **MÁSCARA DESCARTÁVEL, SEMI FACIAL, FILTRANTE**, de fabricação própria, marca **TRE3**, e o **REGISTRO NA ANVISA** de **RESPIRADOR KN95, SEM VÁLVULA, marca: J2 TEXTIL**.

Diante do exposto, após as averiguações complementares na busca de esclarecimentos quanto à proposta da empresa, não sendo possível realizar uma fiel análise do mesmo junto ao objeto do edital, por conta da discordância nas informações apresentadas, concluímos que a empresa está **REPROVADA** para este lote.

Viana/ES, 01 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

  
**Andreia Pereira Nascimento Moreschi**  
Enfermeira – RT de Materiais Médico Hospitalares

  
**Elber Francisco Rocha Mattos**  
Gerência de Suprimentos/FMS  
Portaria Nº 084/2021

**Re: DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES**

De : contato@tre3aventais.com.br

qua, 01 de set de 2021 13:57

**Assunto : Re: DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES**

1 anexo

**Para : Gerencia de Suprimentos <das@viana.es.gov.br>**

- Em 2021-09-01 12:08, Gerencia de Suprimentos escreveu:
- > Prezados(as), boa tarde!
  - > Poderia nos informar o Registro na Anvisa da Máscara apresentada no catálogo? Para os demais itens que compõem o catálogo há o registro na ANVISA, apenas na máscara que não identificamos.
  - > Att,
  - > Elber Mattos
  - > Gerência de Suprimentos
  - > Fundo Municipal de Saude de Viana/ES
  - > 27 3255-1621
  - > ----- Mensagem original -----
  - > De: "contato" <contato@tre3aventais.com.br>
  - > Para: "Gerencia de Suprimentos" <das@viana.es.gov.br>
  - > Enviadas: Quarta-feira, 1 de setembro de 2021 11:43:08
  - > Assunto: Re: DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES
  - >
  - > Em 2021-08-30 11:27, Gerencia de Suprimentos escreveu:
  - >> Prezados(as) srs. (as), bom dia!
  - >>
  - >> Informamos que a equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Viana-ES, esta realizando a análise de amostras e documentações de qualificação técnica do Pregão Eletrônico Nº 038/2021, onde a empresa TRE 3 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI foi declarada arrematante do lote: 15.

- >> Para tanto, estamos realizando esta diligência junto a empresa a fim de sanar dúvidas quanto ao produto ofertado e o Registro na ANVISA.
- >>
- >> A empresa não apresentou amostra física, catálogo, folder, prospecto ou documento similar para que pudéssemos avaliar tecnicamente a proposta.
- >>
- >> Juntamente com sua proposta, MÁSCARA DE PROTEÇÃO Nº 95, marca: TRE, de fabricação própria (em anexo), a empresa nos apresentou laudos (NELSONS LABS [em inglês], FITESA, CONTROLBIO, BIATEX), bem como o Nº de Registro na ANVISA: 81988620001 da MÁSCARA DESCARTAEAL PFF2 SEM VALVULA, marca: GLOBODESC (em anexo). Além disso, nossa RT em Materiais Médicos Hospitalares, Andreia Moreschi, realizou contato via WhatsApp, 31 99672-4000 (em anexo), em 25/08/2021, sendo atendida pela senhora Zeni, onde solicitamos maiores detalhes sobre o produto

- >> ofertado, em 4. nos foi enviado a a fotografia do produto, sendo:
- >> MÁSCARA KN95, registro na ANVISA Nº 82167630009, marca: J2 TEXTIL.
- >>

- >> Diante das divergências demonstradas acima, solicitamos esclarecimentos da empresa quanto sua proposta para o lote 15 e a apresentação de documentação(es) que nos permitam a análise técnica do produto relacionado à sua proposta, bem como o Registro na ANVISA.
- >>

- >> Desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos retorno em um prazo de ate 48H. Após este prazo, não havendo retorno, daremos prosseguimento à análise com as informações constantes nos autos do processo nº 9.690/2020.
- >>

- >> Atenciosamente,
- >> Elber Mattos
- >> Gerência de Suprimentos
- >> Fundo Municipal de Saude de Viana/ES
- >> 27 32551621
- >

- > Bom dia
- >
- > Segue em anexo o nosso catalogo, caso preciseinei enviar a amostra
- >
- > Atenciosamente

Boa tarde

Segue em anexo o registro

— REGISTRO MASCARA.pdf

221 KB

De : contato@tre3aventais.com.br

qua, 01 de set de 2021 12:55

3 anexos

**Assunto : Re: DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES**

**Para : Gerencia de Suprimentos <das@viana.es.gov.br>**

**Cc : licitacao <licitacao@viana.es.gov.br>**,  
andrelamoreschi <andrelamoreschi@hotmail.com>

Em 2021-09-01 12:08, Gerencia de Suprimentos escreveu:

- > Prezados(as), boa tarde!
- >
- > Poderia nos informar o Registro na Anvisa da Máscara apresentada no catálogo? Para os demais itens que compõem o catálogo há o registro na ANVISA, apenas na máscara que não identificamos.
- >
- > Att,
- >
- > Elber Mattos
- > Gerência de Suprimentos
- > Fundo Municipal de Saude de Viana/ES
- > 27 3255-1621



> > ----- Mensagem original -----  
 > De: "contato" <contato@tre3aventais.com.br>  
 > Para: "Gerencia de Suprimentos" <das@viana.es.gov.br>  
 > Enviadas: Quarta-feira, 1 de setembro de 2021 11:43:08  
 > Assunto: Re: DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES

> Em 2021-08-30 11:27, Gerencia de Suprimentos escreveu:  
 > Prezado(as) srs. (as), bom dia!

>> Informamos que a equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de  
 >> Viana-ES, esta realizando a análise de amostras e documentações de  
 >> qualificação técnica do Pregão Eletrônico Nº 038/2021, onde a  
 >> empresa TRE 3 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI foi declarada  
 >> arrematante do lote: 15.

>> Para tanto, estamos realizando esta diligência junto a empresa a fim  
 >> de sanar dúvidas quanto ao produto ofertado e o Registro na ANVISA.

>> A empresa não apresentou amostra física, catálogo, folder, prospecto  
 >> ou documento similar para que pudéssemos avaliar tecnicamente a  
 >> proposta.

>> Juntamente com sua proposta, MÁSCARA DE PROTEÇÃO Nº 95, marca:  
 >> TRE, de fabricação própria (em anexo), a empresa nos apresentou  
 >> laudos (NELSONS LABS [em inglês], FITESA, CONTROLBIO, BIATEX), bem  
 >> como o Nº de Registro na ANVISA: 81988620001 da MÁSCARA DESCARTAE  
 >> PFF2 SEM VALVULA, marca: GLOBODESC (em anexo). Além disso, nossa RT  
 >> em Materiais Médicos Hospitalares, Andreia Moreschi, realizou contato  
 >> via WhatsApp, 31 99672-4000 (em anexo), em 25/08/2021, sendo atendida  
 >> pela senhora Zeni, onde solicitamos maiores detalhes sobre o produto  
 >> ofertado, em que nos foi enviado a a fotografia do produto, sendo:  
 >> MÁSCARA KN95, registro na ANVISA Nº 82167630009, marca: J2 TEXTIL.

>> Diante das divergências demonstradas acima, solicitamos  
 >> esclarecimentos da empresa quanto sua proposta para o lote 15 e a  
 >> apresentação de documentação(es) que nos permitam a análise  
 >> técnica do produto relacionado à sua proposta, bem como o Registro  
 >> na ANVISA.

>> Desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos retorno em  
 >> um prazo de até 48h. Após este prazo, não havendo retorno, daremos  
 >> prosseguimento à análise com as informações constantes nos autos  
 >> do processo nº 9.690/2020.

>> Atenciosamente,  
 >> Elber Mattos  
 >> Gerência de Suprimentos  
 >> Fundo Municipal de Saúde de Viana/ES  
 >> 27 32551621

> Bom dia

> Segue em anexo o nosso catalogo, caso precise irai enviar a amostra

> Atenciosamente

Boa tarde,  
 segue todas informacoes necessarias

— Kn95\_Texmed (1).pdf  
 223 KB

— Mascaras N95 (1).pdf  
 2 KB



WhatsApp Image 2021-09-01 at 12.48.35.jpeg  
 64 KB

De : Gerencia de Suprimentos <das@viana.es.gov.br> qua, 01 de set de 2021 12:08  
 Assunto : Re: DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES

Para : contato <contato@tre3aventais.com.br>

Cc : licitacao <licitacao@viana.es.gov.br>,  
 andreamoreschi <andreamoreschi@hotmail.com>  
 Prezados(as), boa tarde!

Poderia nos informar o Registro na Anvisa da Máscara apresentada no  
 catálogo? Para os demais itens que compõem o catálogo há o registro na  
 ANVISA, apenas na máscara que não identificamos.

Att,

Elber Mattos  
 Gerência de Suprimentos  
 Fundo Municipal de Saúde de Viana/ES  
 27 3255-1621

----- Mensagem original -----

De: "contato" <contato@tre3aventais.com.br>  
 Para: "Gerencia de Suprimentos" <das@viana.es.gov.br>  
 Enviadas: Quarta-feira, 1 de setembro de 2021 11:43:08  
 Assunto: Re: DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES

Em 2021-08-30 11:27, Gerencia de Suprimentos escreveu:

> Prezado(as) srs. (as), bom dia!  
 > Informamos que a equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de  
 > Viana-ES, esta realizando a análise de amostras e documentações de  
 > qualificação técnica do Pregão Eletrônico Nº 038/2021, onde a  
 > empresa TRE 3 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI foi declarada  
 > arrematante do lote: 15.

> Para tanto, estamos realizando esta diligência junto a empresa a fim

- > de sanar dúvidas quanto ao produto ofertado e o Registro na ANVISA.
- >
- > A empresa não apresentou amostra física, catálogo, folder, prospecto ou documento similar para que pudéssemos avaliar tecnicamente a proposta.
- >
- > Juntamente com sua proposta, MÁSCARA DE PROTEÇÃO Nº 95, marca: TRE, de fabricação própria (em anexo), a empresa nos apresentou laudos (NELSONS LABS [em inglês], FITESA, CONTROLBIO, BIATEX), bem como o Nº de Registro na ANVISA: 81988620001 da MÁSCARA DESCARTÁEL PFF2 SEM VÁLVULA, marca: GLOBODESC (em anexo). Além disso, nossa RT em Materiais Médicos Hospitalares, Andreia Moreschi, realizou contato via WhatsApp, 31 99672-4000 (em anexo), em 25/08/2021, sendo atendida pela senhora Zeni, onde solicitamos maiores detalhes sobre o produto ofertado, em que nos foi enviado a a fotografia do produto, sendo: MÁSCARA KN95, registro na ANVISA Nº 82167630009, marca: J2 TEXTIL.
- >
- > Diante das divergências demonstradas acima, solicitamos esclarecimentos da empresa quanto sua proposta para o lote 15 e a apresentação de documentação(es) que nos permitam a análise técnica do produto relacionado à sua proposta, bem como o Registro na ANVISA.
- >
- > Desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos retorno em um prazo de até 48H. Após este prazo, não havendo retorno, daremos prosseguimento à análise com as informações constantes nos autos do processo nº 9.690/2020.
- >
- > Atenciosamente,
- > Elber Mattos
- > Gerência de Suprimentos
- > Fundo Municipal de Saúde de Viana/ES
- > 27 32551621

Bom dia

Segue em anexo o nosso catálogo, caso precise irei enviar a amostra

Atenciosamente

De : contato@tre3aventais.com.br

Assunto : Re: DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES

Para : Gerencia de Suprimentos <das@viana.es.gov.br>  1 anexo

Em 2021-08-30 11:27, Gerencia de Suprimentos escreveu:

- > Prezado(as) srs. (as), bom dia!
- >
- > Informamos que a equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Viana-ES, esta realizando a análise de amostras e documentações de qualificação técnica do Pregão Eletrônico Nº 038/2021, onde a empresa TRE 3 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI foi declarada arrematante do lote: 15.
- >

- > Para tanto, est ds realizando esta diligência junto a empresa a fim de sanar dúvidas quanto ao produto ofertado e o Registro na ANVISA.
- >
- > A empresa não apresentou amostra física, catálogo, folder, prospecto ou documento similar para que pudéssemos avaliar tecnicamente a proposta.
- >
- > Juntamente com sua proposta, MÁSCARA DE PROTEÇÃO Nº 95, marca: TRE, de fabricação própria (em anexo), a empresa nos apresentou laudos (NELSONS LABS [em inglês], FITESA, CONTROLBIO, BIATEX), bem como o Nº de Registro na ANVISA: 81988620001 da MÁSCARA DESCARTÁEL PFF2 SEM VÁLVULA, marca: GLOBODESC (em anexo). Além disso, nossa RT em Materiais Médicos Hospitalares, Andreia Moreschi, realizou contato via WhatsApp, 31 99672-4000 (em anexo), em 25/08/2021, sendo atendida pela senhora Zeni, onde solicitamos maiores detalhes sobre o produto ofertado, em que nos foi enviado a a fotografia do produto, sendo: MÁSCARA KN95, registro na ANVISA Nº 82167630009, marca: J2 TEXTIL.
- >
- > Diante das divergências demonstradas acima, solicitamos esclarecimentos da empresa quanto sua proposta para o lote 15 e a apresentação de documentação(es) que nos permitam a análise técnica do produto relacionado à sua proposta, bem como o Registro na ANVISA.
- >
- > Desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos retorno em um prazo de até 48H. Após este prazo, não havendo retorno, daremos prosseguimento à análise com as informações constantes nos autos do processo nº 9.690/2020.
- >
- > Atenciosamente,
- > Elber Mattos
- > Gerência de Suprimentos
- > Fundo Municipal de Saúde de Viana/ES
- > 27 32551621

Bom dia

Segue em anexo o nosso catálogo, caso precise irei enviar a amostra

Atenciosamente

— CATALOGO TRE.pdf

4 MB

De : Gerencia de Suprimentos <das@viana.es.gov.br> seg, 30 de ago de 2021 11:27

Assunto : DILIGÊNCIA PE Nº 038/2021 - VIANA/ES  3 anexos

Para : contato@tre3aventais.com.br

Cc : andreiamoreschi <andreiamoreschi@hotmail.com>, licitacao <licitacao@viana.es.gov.br>

Prezado(as) srs. (as), bom dia!

Prefeitura Municipal de Viana

Fhs. nº 1017

Processo nº 9620/2020



Informamos que a equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde de Viana-ES, está realizando a análise de amostras e documentações de qualificação técnica do **Pregão Eletrônico Nº 038/2021**, onde a empresa **TRE 3 COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI** foi declarada arrematante do lote: 15.

Para tanto, estamos realizando esta diligência junto a empresa a fim de sanar dúvidas quanto ao produto ofertado e o Registro na ANVISA.

A empresa **não apresentou** amostra física, catálogo, folder, prospecto ou documento similar para que pudéssemos avaliar tecnicamente a proposta.

Juntamente com sua proposta, **MÁSCARA DE PROTEÇÃO Nº 95, marca: TRE, de fabricação própria (em anexo)**, a empresa nos apresentou laudos (NELSONS LABS [em inglês], FITESA, CONTROLBIO, BIATEX), bem como o Nº de Registro na ANVISA: 81988620001 da **MÁSCARA DESCARTÁEL PFF2 SEM VÁLVULA, marca: GLOBODESC (em anexo)**. Além disso, nossa RT em Materiais Médicos Hospitalares,

Andreia Moreschi, realizou contato via WhatsApp, 31 99672-4000 (**em anexo**), em 25/08/2021, sendo atendida pela senhora Zeni, onde solicitamos maiores detalhes sobre o produto ofertado, em que nos foi enviado a a fotografia do produto, sendo: **MÁSCARA KN95, registro na ANVISA Nº 82167630009, marca: J2 TEXTIL**.

Diante das **divergências** demonstradas acima, solicitamos esclarecimentos da empresa quanto sua proposta para o lote 15 e a apresentação de documentação(es) que nos permitam a análise técnica do produto relacionado à sua proposta, bem como o Registro na ANVISA.

Desde já agradecemos a atenção dispensada e aguardamos retorno em um prazo de até 48H. Após este prazo, não havendo retorno, daremos prosseguimento à análise com as informações constantes nos autos do processo nº 9.690/2020.

Atenciosamente,

**Elber Mattos**

Gerência de Suprimentos

Fundo Municipal de Saúde de Viana/ES

27 32551621

Prefeitura Municipal de Viana

Flt. nº 1018 Proc. nº 9690/2020



WhatsApp Image 2021-08-30 at 11.20.49.jpeg

146 KB



WhatsApp Image 2021-08-30 at 11.20.38.jpeg

145 KB



WhatsApp Image 2021-08-30 at 10.59.24.jpeg

66 KB




**Avental  
Descartável**



(31) **3213-7661**  
contato@tre3aventais.com.br

 [tre3aventais.com.br](http://tre3aventais.com.br)

Tre3 aventais hospitalares Ltda Cnpj 41.388.986/0001-04

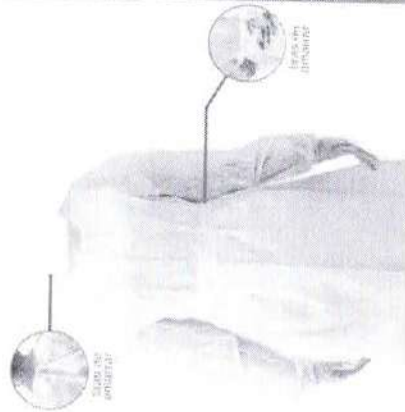

## DESCRIÇÃO

### Avental Descartável Manga Longa TNT

**COMPOSIÇÃO:** 100% polipropileno

Material atóxico, cor branca, não estéril, um par de tiras no pescoço e um par de tiras na cintura para ajustes embutidos no próprio avental.

**Embalagem:** Embalado em pacotes com 10 unidades

**Tamanho:** 1,40m X 1,05m "ou sob medida"

**Gramaturas:** 20g, 30g e 40g (conforme ABNT 12984)

**Cor:** Branco

**Validade:** 2 anos

**NCM:** 6307.9010

**ANVISA:** 81100920001

Conservar em local arejado e temperatura ambiente.  
Produto de uso único.

Prefeitura Municipal de Viana


Ft. n.º 2019

13/05/2019





# Avental Descartável



## DESCRIÇÃO

### Avental Descartável Manga Longa Impermeável

**COMPOSIÇÃO:** 100% polipropileno revestido de polietileno.

Material atóxico, cor branca, não estéril, um par de tiras no pescoço e um par de tiras na cintura para ajustes embutidos no próprio avental.

**IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS PULVERIZADOS E RESPINGOS**

**Embalagem:** Embalado em pacotes com 10 unidades

**Tamanho:** 1,40m X 1,15m "ou sob medida"

**Gramatura:** 30g-40g-50g (conforme ABNT 1.2984)

**Cor:** Branco

**Validade:** 2 anos


**NCM:** 6307.9010

**ANVISA:** 81100920016

Produto de uso único.



# Máscara Descartável



## DESCRIÇÃO

Máscara semi facial, filtrante de partículas, conforme norma NBR 13698. Com elástico e clip nasal. Vedada em todas as extremidades. Características: Descartável, não inflamável, atóxica.

### Especificações técnicas:

Confeccionado em TNT - Tecido Não Tecido • Elemento filtrante com tratamento eletrostático. Eficiência a filtração de bactérias (BFE) superior a 95%.

**Caixa com 50 unidades.** Atóxico | Cor: Branco | Gramatura: 30g/m, 40g/m.

### Recomendado para:

Proteção contra patologias, poeiras, névoas e fumos que possam atingir a via respiratória.

Indicada para: Uso na área de Saúde e Industrial.

### Armazenagem:


Mantier em local seco e arejado, protegido da luz solar e intempéries.



## Macacão Hospitalar Descartável Laminado



## Propé Descartável em TNT



### DESCRIÇÃO

Macacão manga longa, extremamente resistente a partículas de poeira de diversos tipos e alta repelência à fluidos, ótima praticidade na abertura e fechamento com zíper, com capuz, punhos e barras com elástico 4mm para melhor aderência nas extremidades. Isento de látex, alta resistência e baixo desprendimento de partículas.

Produzido em TNT hidrofóbico (imp. de > 98%) e com filtração bactericida (BFE > 99%) aplicado um filme de polietileno na superfície externa.

**Embalagem:** Embalado em pacotes com 10 unidades

**Gramatura:** 30g-40g-50g

**Cor:** Branco

**Validade:** 3 anos

**NCM:** 6307.9010

**Tamanho:** Único (baseado na numeração até 43)

**ANVISA:** 81100920005



### DESCRIÇÃO

#### Propé Descartável em TNT

**COMPOSIÇÃO:** 100% polipropileno - Material atóxico

**Embalagem:** Embalado em pacotes com 100 unidades

**Gramatura:** 20g e 30g (conforme ABNT 12984)

**Cor:** Branco

**Validade:** 2 anos

**NCM:** 6307.9010

**Tamanho:** Único (baseado na numeração até 43)

**ANVISA:** 81100920005

Conservar em local arejado e temperatura ambiente.  
Produto de uso único.

Prefeitura Municipal de Vicna

Fls. nº 1021

Protocolo nº 9890/2020





# Touca Descartável Sanfonada



## DESCRIÇÃO

### Touca Descartável Sanfonada

**COMPOSIÇÃO:** 100% polipropileno - Material atóxico

**Embalagem:** Embalado em pacotes com 100 unidades

**Gramatura:** 20g (conforme ABNT 12984)


**Cores:** Branco, azul, verde, vermelho e rosa

**Validade:** 2 anos

**NCM:** 6307.9010

**ANVISA:** 81100920002

Conservar em local arejado e temperatura ambiente.  
Produto de uso único.



## RESPIRADOR KN95 - SEM VÁLVULA

O respirador KN95 (equivalente a Pff2/N95) é uma peça semi facial filtrante de partículas, foi desenvolvida para garantir a proteção da saúde contra patologias, poeiras, névoas e fumos que possam atingir a via respiratória. Para maior segurança a máscara da Texmed é vedada em todas as extremidades por soldagem eletrônica, ficando livre de costura aparentes ou imperfeições que possam causar um desconforto.

### DESEMPENHO:

Este respirador enquadra-se na categoria D.1 b) peça semifacial filtrante para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Respirador conforme norma NBR 13698 para Peça Semifacial Filtrante.

✓ Penetração máxima através do filtro	6%
✓ Resistência máxima a inalação	240 Pa
✓ Resistência máxima a exalação	300 Pa
✓ Determinação da Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE)*	98,0%

\*Laboratório Freitag. Relatório de Ensaio A\_48692.2020\_Te\_1\_1.

### CAMADAS:

É confeccionada em cinco camadas sendo as Três camadas em TNT (Tecido não tecido) com 35 gr/m<sup>2</sup>, 100% polipropileno e mais duas camadas internas de filtro Meltblown de 30 gr/m<sup>2</sup> o que garante a eficiência à filtração de bactérias (BFE) superior a 95%.

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Cor Branca, Preta ou Rosa;
  - ✓ Medida aberta possui 22 cm de largura x 13 cm de altura;
  - ✓ Possui dois elásticos anatômicos com 17 cm que envolve a orelha;
  - ✓ Clip nasal interno de metal revestido com PVC, medindo 5 mm de largura por 9 cm de comprimento;
- ✓ Livre de Látex;
  - ✓ Isenta de Fibras de Vidro;
  - ✓ Não Inflamável;
  - ✓ Não Estéril;
  - ✓ Atóxica;
  - ✓ Descartável;
  - ✓ Embalagem Individual.

Registro ANVISA 82167630009





## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	J2 TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI
CNPJ	19.785.901/0001-64
Autorização	8.21.676-3
Produto	MÁSCARA RESPIRADOR KN95

Modelo Produto Médico
Máscara KN95, sem válvula, descartável, quatro camadas

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Mascaras
Registro	82167630009
Processo	25351270335202177
Fabricante Legal	J2 TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>